

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного учреждения
«Республиканский научно-практический
центр медицинских технологий,
информатизации, управления и
экономики здравоохранения»



М.М.Сачек

2020 г.

**ЗАПРОС ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № G 3.5
на закупку встроенной мебели и оборудования.**

Название проекта: Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь
Источник финансирования: Средства Займа Международного банка реконструкции и развития (Заем № 8663-BY).

1. Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» (далее – Плательщик) приглашает Вас представить ценовое предложение на закупку встроенной мебели и оборудования.

№ п/п	Наименование	Количество
Лот № 1 Мебель для постов медицинских сестер		
1.	Комплект мебели индивидуального изготовления для постов медицинских сестер (для 2-го и 3-го этажей)	2
2.	Комплект мебели индивидуального изготовления для постов медицинских сестер (для 4-го этажа)	1
Лот № 2 Кухонная мебель		
3.	Комплект кухонной мебели индивидуального изготовления с электрической варочной панелью, со встроенной мойкой в комплекте со смесителем, сифоном, подводками (для молочного блока)	1
4.	Комплект кухонной мебели индивидуального изготовления со встроенной мойкой в комплекте со смесителем, сифоном, подводками	1
Лот № 3 Шкафы		
5.	Шкаф-кровать индивидуального изготовления, откидная	4
6.	Шкаф одностворчатый, индивидуального изготовления с отделением для встроенного холодильника, печи СВЧ, полками для хранения, с вентилируемой задней стенкой	4
Лот № 4 Система подготовки очищенной воды		
7.	Система подготовки очищенной воды по принципу «Обратный осмос» в комплекте	1

Технические характеристики оборудования указаны в Приложении 1 к настоящему Запросу ценовых предложений.

2. Вы должны указать цены на все перечисленные наименования продукции. Оценка будет проводиться по всем наименованиям вместе, и договор будет присужден фирме, предлагающей самую низкую общую цену по всем наименованиям. Плательщик имеет право отклонить любые предложения, а также не несет ответственности за любые расходы, связанные с подготовкой и подачей предложений участниками, независимо от результата проведения процесса отбора.

3. **Подача ценовых предложений:** Ценовые предложения должны быть представлены **не позднее 31 декабря 2020 г. по адресу: Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 7-А, кабинет 31** посредством почтовой связи или доставки курьером (представителем).

Плательщик может при необходимости продлевать окончательный срок представления предложений (в период до его истечения) в случае, если изданы дополнения к документации.

4. Ваше ценовое предложение на русском языке должно сопровождаться соответствующими техническими пояснениями по каждому наименованию товара, по которому названа цена. Технические характеристики, функциональные параметры и производительность предложенных Участником торгов Товаров должны в обязательном порядке отвечать требованиям, указанным в Технических спецификациях. Товары, не отвечающие Техническим спецификациям, признаются несоответствующими требованиям торгов. Ценовое предложение должно быть оформлено на бумажном носителе в письменной форме на русском языке в одном экземпляре. Предложение участника должно быть подписано уполномоченным должностным лицом.

Полномочия уполномоченного должностного лица должны быть установлены Уставом и (или) соответствующим приказом, или соответствующей доверенностью на участника, прилагаемой к предложению.

5. Цены на продукцию должны быть сформированы в белорусских рублях с учетом доставки до места назначения, разгрузки/погрузки, а также с учетом монтажа. Оплата будет производиться в белорусских рублях.

Цена на поставку продукции должна быть указана без учета налога на добавленную стоимость (НДС) согласно подпункту 5.3 Распоряжения Президента Республики Беларусь от 21.08.2017 № 135рп «О реализации Соглашения о займе» (ссылка: http://rnpcomt.belcmt.by/index.php?option=com_content&view=article&id=129:2017-08-30-08-51-26&catid=23:2017-07-07-08-16-42&Itemid=68).

Предложения, которые по существу отвечают техническим требованиям, будут оцениваться посредством их сопоставления. При оценке ценовых предложений Заказчик определит по каждому предложению оценочную стоимость путем корректировки ценового предложения при помощи внесения коррективов любых арифметических погрешностей в следующих случаях:

- при несоответствии между суммами в цифрах и словами, сумма, указанная словами будет определяющей;
- при несоответствии между ценой за единицу и пунктом всего, полученных в результате умножения цены за единицу на количество, заявленная цена за единицу будет определяющей;
- в случае, если Подрядчик отказывается принять корректировку, его предложение будет отклонено.

6. Договор будет присужден участнику, предложившему согласно оценке наименьшую цену, которая отвечает требованиям Спецификации и Техническому

заданию согласно Приложению 1 к настоящему запросу. Любое предложение, которое не соответствует требованиям, будет отклонено.

7. Ценовое предложение должно быть оформлено в соответствии с Приложением 2 и должно быть действительно в течение 120 дней после окончательной даты подачи предложений, указанной в пункте 3 настоящего запроса ценовых предложений.

8. Требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

8.1. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также индивидуальный предприниматель.

8.2. Квалификационные требования к участникам:

8.2.1. наличие авторизованных сервисных центров или сертифицированных специалистов в Республики Беларусь;

8.2.2. наличие опыта работы компании-претендента на рынке поставок мебели и оборудования не менее 3-х лет;

8.2.3. участник не должен иметь действующих претензий за последний год по ненадлежащему исполнению договорных обязательств в части, касающейся качества и сроков поставки оборудования;

8.2.4. обязательно наличие у претендента:

- сертификатов соответствия на поставляемое оборудование;

- сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям СТБ ИСО 9001-2009;

- гарантийных обязательств на поставляемое оборудование не менее 24 месяцев,

8.3. Участники представляют ценовое предложение, которое должно содержать следующие документы:

- заявление на участие с указанием полного наименования, сведений об организационно-правовой форме (для организаций), фамилии, собственного имени и отчества, паспортных данных (для физического лица, включая индивидуального предпринимателя), места нахождения (места жительства), адреса электронной почты (при наличии), номера контактного телефона (Приложение 2, информационная форма);

- заявление о том, что участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации, либо индивидуальный предприниматель не находится в стадии прекращения деятельности, или не признаны в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельными (банкротами), за исключением находящихся в процедуре санации (Приложение 2, информационная форма);

- согласие участника выполнить условия настоящего запроса ценовых предложений и проекта договора (Приложение 2, информационная форма, Приложение 3);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- технические пояснения по каждому наименованию товара;

- документы, подтверждающие наличие авторизованных сервисных центров или сертифицированных специалистов в Республике Беларусь;

- документы, подтверждающие наличие опыта работы компании-претендента на рынке поставок мебели и оборудования не менее 3-х лет;

- документы, подтверждающие, отсутствие претензий за последний год по ненадлежащему исполнению договорных обязательств в части, касающейся качества и сроков поставки оборудования;

- сертификаты соответствия на поставляемое оборудование;

- сертификаты соответствия системы менеджмента качества требованиям СТБ ИСО 9001-2009;

- гарантийные обязательства на поставляемое оборудование не менее 24 месяцев,

- другие документы, по усмотрению участника, подтверждающие его квалификационные данные.

9. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (017) 395-19-42;
Электронная почта: tender.wb@belcmt.by

10. Просим подтвердить по электронной почте получение настоящего запроса и сообщить нам о том, намереваетесь ли Вы представить ценовое предложение.

Заведующий ОУП



А.А.Кобель

Технические спецификации

Общие требования, предъявляемые для встроенной мебели и оборудования.

1. Год выпуска и срок службы: Вся мебель и оборудование их компоненты должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не ранее 2020 года выпуска, надлежащего качества, без дефектов.

Полный срок службы каждой единицы мебели и оборудования (за исключением быстроизнашивающихся деталей и частей) – в соответствии с установленным изготовителем сроком.

2. Техническая документация, передаваемая Поставщиком Покупателю: Каждая единица мебели и оборудования должна иметь техническую и эксплуатационную (руководства по эксплуатации и обслуживанию) документацию и паспорт изделия на русском языке или на другом языке с переводом содержания на русский язык. В технической документации должно содержаться полное и точное описание оборудования, технологии его сборки и разборки, а также всех компонентов. В эксплуатационную (руководства по эксплуатации и обслуживанию) документацию должны быть включены инструкции по техническому обслуживанию оборудования в целях обеспечения безопасности. Программное обеспечение (если таковое имеется) должно быть на русском языке.

3. Материал оборудования: материал, из которого изготовлена мебель и оборудование, должен быть апирогенным, нетоксичным и пригодным для обработки моющими и антисептическими веществами.

4. Гарантия: Не менее 24 месяцев на каждую единицу или на каждый комплект мебели и оборудования от даты подписания акта выполненных работ.

Качество мебели и оборудования должно соответствовать стандартам изготовителя. Поставщик гарантирует качество мебели и оборудования в целом, включая составные части и комплектующие.

5. Гарантийное обслуживание: В гарантийный период гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком или уполномоченными представителями Поставщика за счет Поставщика и должно покрывать расходы на оплату труда, материалы и части.

Поставщик должен обеспечить гарантийный ремонт, восстановление нормального функционирования мебели и оборудования и замену неисправных частей поставленной мебели и оборудования по запросу Получателя в течение 14 дней с даты получения такого запроса (если потребуется, квалифицированный специалист Поставщика должен быть направлен на место установки мебели и оборудования для устранения неисправностей не позднее 5 суток с момента получения запроса).

Поставщик гарантирует, что в течение гарантийного периода транспортировка мебели и оборудования и его частей с места эксплуатации мебели и оборудования в сервисный центр Поставщика и обратно к месту эксплуатации для осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, в случае необходимости, осуществляется за счет Поставщика.

В случае устранения выявленных дефектов, недостатков, неисправностей мебели и оборудования, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого мебель и оборудование не использовалось из-за устранения выявленных дефектов, недостатков или неисправностей. При замене любой единицы мебели и оборудования в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

Поставщик должен организовать службу технической поддержки (в рамках рабочего

времени) включая предоставление ответов по всем вопросам эксплуатации мебели и оборудования, рекомендации по эксплуатации, классификации проблем и формулировке рекомендаций по телефону, электронной почте или с использованием других средств коммуникации.

6. Послегарантийное сервисное обслуживание: Поставщик должен обеспечить послегарантийное сервисное обслуживание мебели и оборудования в течение как минимум 3 лет с момента окончания срока гарантии (по отдельному договору с Получателем мебели и оборудования, при необходимости).

Устранение неисправностей и обслуживание мебели и оборудования в послегарантийный период, в случае необходимости, должно осуществляться квалифицированными специалистами Поставщика в течение разумного промежутка времени с момента письменного уведомления Получателя на месте эксплуатации мебели и оборудования на основании сервисного договора, заключаемого между Получателем и Поставщиком.

7. Сертификация: Предлагаемая мебель и оборудование должны быть от производителей / поставщиков, сертифицированных по системе качества ISO 9001 (системы сертификации качества эквивалентные ISO также будут приниматься к рассмотрению) и/или предлагаемая мебель и оборудование должны иметь действительный сертификат/декларацию качества/соответствия или иной документ, подтверждающий качество мебели и оборудования, или маркировку знаком соответствия.

Сертификаты соблюдения экологических норм, маркировки и иные доказательства применения участником торгов практик, способствующих экологической устойчивости и снижению негативных воздействий на окружающую среду (например, использование нетоксичных веществ, материалов вторичной переработки, энергоэффективного оборудования, снижения выбросов углекислого газа, и тд.), в своих бизнес-процессах или в производственной деятельности – желательное, но не обязательное требование.

8. Процедура приемки: Процедура приемки мебели и оборудования осуществляется Покупателем при участии представителей Поставщика и Получателя после получения Товара в пунктах конечного назначения в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290 «Об утверждении положения о приемке товаров по количеству и качеству».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Комплект мебели индивидуального изготовления для постов медицинских сестер (для 2-го и 3-го этажей)

№п/п	Наименование позиции/ Требуемые характеристики	Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру
1.	Наименование, количество и область применения	
1.1.	Наименование: Комплект функциональной модульной мебели индивидуального изготовления для постов медицинских сестер	Соответствие
1.2.	Количество, шт.	2
1.3.	Область применения: организованное хранение медикаментов и расходных материалов, обеспечение рабочих мест медицинских реанимационных сестер в отделении анестезиологии и реанимации	Соответствие
2.	Состав (комплектация одного комплекта) оборудования:	
2.1	Шкаф высокий с выдвижными ящиками с системами хранения, г.р. ШхГхВ (500-600х550х2000-2050) – 3 штуки	Наличие
2.2	Шкаф низкий с выдвижными ящиками с системами хранения, г.р. ШхГхВ (400-600х550х800) – 24 штуки	Наличие
2.3	Шкаф низкий для встроенного холодильника, одностворчатый, г.р. ШхГхВ (500-600х550х800) – 4 штуки	Наличие
2.4	Шкаф низкий для встроенной мойки и мусорных контейнеров с двумя выдвижными створками, г.р. ШхГхВ (800-1000х550х800) – 4 штуки	Наличие
2.5	Шкаф низкий для встроенного умывальника и мусорных контейнеров с двумя выдвижными створками, г.р. ШхГхВ (800-1000х550х800) – 4 штуки	Наличие
2.6	Шкаф низкий, двустворчатый, г.р. ШхГхВ (900-1000х550х800) – 4 штуки	Наличие
2.7	Шкаф навесной, двустворчатый, г.р. ШхГхВ (800-1000х300-350х500) – 18 штук	Наличие
2.8	Шкаф навесной, одностворчатый, г.р. ШхГхВ (400-600х300-350х500) – 8 штук	Наличие
2.9	Стол приставной, г.р. ШхГхВ (900х700х850-900) – 4 штуки	Наличие
2.10	Мойка с широкой чашей (типа Corian 881) – 4 штуки	Наличие
2.11	Комплект сантехнического оборудования для мойки: сифон из нержавеющей стали, с донным клапаном, с переливом; смеситель с высоким изливом, с вытягивающимся шлангом с лейкой, с термостатом (типа Grohtherm Micro); гибкие подводки холодной и горячей воды; кран для очищенной воды с поворотным S-образным изливом для установки в стену (типа FAR 11030.1-11030.2) – 4 комплекта	Наличие
2.12	Умывальник с узкой чашей (типа Corian 802) – 4 штуки	Наличие
2.13	Комплект сантехнического оборудования для умывальника: сифон из нержавеющей стали, с донным клапаном, с переливом; смеситель с локтевым или бесконтактным (на аккумуляторах) включением, с термостатом (типа Grohtherm Micro); гибкие подводки холодной и горячей воды – 4	Наличие

	комплекта	
2.14	Выдвижной модуль на 2 мусорных контейнера – 16 штук	Наличие
2.15	Столешница – 1 комплект	Наличие
2.16	Доборные элементы – 1 комплект	Наличие
2.17	Цоколь с высотой регулировки от 70 до 100мм – 1 комплект	Наличие
3.	Общие требования	
3.1	Инструкция по сборке и эксплуатации на русском языке	Наличие
3.2	Выполнение обмеров помещений за счет поставщика	Наличие
3.3	Конструкторскую документацию на изготовление выполняет производитель, с учетом фактических обмеров помещений	Наличие
3.4	Сборка и монтаж на объекте за счет поставщика	Наличие
3.5	Гарантийное обслуживание за счет поставщика	Не менее 24 месяцев
4.	Технические требования и характеристики:	
4.1	Мебельная сборка представляет собой комплект модульной мебели, состоящая из напольных и навесных шкафов, приставных столиков, оснащенных системами хранения, комплектом сантехнического оборудования. Примерная схема мебельных сборок приведена в Приложении 1. Ширина модулей может отличаться от схемы, в зависимости от реальных размеров помещения и применяемых систем хранения в ящиках	Соответствие
4.2	Корпусные детали и дно – из HPL толщиной не менее 12мм; цвета – светло-серый, белый или бежевый (по согласованию с Пользователем)	Соответствие
4.3	Задняя стенка – из HPL толщиной не менее 3мм, вставляется в канавки и привинчивается. Цвета – светло-серый, белый или бежевый (по согласованию с Пользователем)	Соответствие
4.4	Лицевые детали (фасад) – из HPL толщиной не менее 12мм. Канты фрезеруются в форме эллипса и полируются	Соответствие
4.5	Дно и задняя стенка выдвижного ящика – из HPL толщиной не менее 10мм. Глубина ящика не менее 500мм	Соответствие
4.6	Выдвижные ящики оснащаются системой роликовых телескопических направляющих полного выдвижения, со встроенным доводчиком, с расчетной нагрузкой 60кг. Допустимая нагрузка на каждый выдвижной ящик не менее 50 кг	Соответствие
4.7	Все ящики должны быть оснащены системами хранения - съемными лотками из ABS-пластика с переставляемыми разделителями	Соответствие
4.8	Верхние ящики низких шкафов должны быть оснащены замками. Ключ должен подходить ко всем замкам в группе шкафов одного поста медсестер (согласовать с эксплуатирующей организацией)	Соответствие
4.9	По периметру каждого ящика или двери должны быть предусмотрены силиконовые уплотнители, защищающие от попадания пыли	Соответствие
4.10	Двустворчатые шкаф должны иметь вертикальную перегородку из HPL толщиной не менее 12мм, разделяющую шкаф на два отсека	

4.11	Шкаф высокий (2.1) должен иметь 7 выдвижных ящика высотой 200-250 мм каждый. Над ящиками располагается одностворчатая ниша с двумя полками, разделяющими пространство ниши на равные части. Для герметичного притвора ящика необходимо наличие горизонтальных притворных планок, устанавливаемых заподлицо с горизонтальной плоскостью корпуса шкафа	Соответствие
4.12	Шкаф низкий (2.2) должен иметь 4 выдвижных ящика равной высоты. Для герметичного притвора ящика необходимо наличие горизонтальных притворных планок, устанавливаемых заподлицо с горизонтальной плоскостью корпуса шкафа	Соответствие
4.13	Шкаф для малогабаритного встраиваемого холодильника (2.3). Ориентировочные размеры холодильника ШхГхВ, не более: 540х540х820мм. Окончательные размеры шкафа уточняются у Заказчика на этапе разработки конструкторской документации. В случае превышения указанных размеров холодильника, по согласованию с Заказчиком, допускается установить холодильник в шкаф 2.1, а шкаф 2.3 заменить на шкаф, аналогичный 2.2. На задней стенке предусматривается отверстие для розетки	Соответствие
4.14	Шкаф для мойки (2.4) и умывальника (2.5) должны иметь выдвижные системы контейнеров для отходов – 2 ведра в каждом отсеке, объемом не менее 18л каждое. Выдвижные системы оснащаются системой роликовых телескопических направляющих полного выдвижения, со встроенным доводчиком, с расчетной нагрузкой 60кг. Выдвижение осуществляется совместно с дверью шкафа	Соответствие
4.15	Мойка с широкой чашей (2.10) предназначена для купания новорожденных, изготовлена из акрилового материала (типа Corian), иметь наклонные борта. Глубина мойки не менее 200мм, ширина 350-400мм, длина не менее 600мм. Способ монтажа – клеиваемая снизу. Модель мойки согласовать с эксплуатирующей организацией	Соответствие
4.16	Умывальник (2.12) предназначен для мойки рук, изготовлен из акрилового материала (типа Corian), иметь скругленные борта. Глубина умывальника не менее 100мм, ширина 250-300мм, длина не менее 400мм. Диаметр сливного отверстия 90мм. Способ монтажа – клеиваемая снизу. Модель умывальника согласовать с эксплуатирующей организацией	Соответствие
4.17	Шкаф (2.6) для размещения компьютера и сейфа с распашными дверцами, устанавливается на poste медицинских сестер. Дверь отсека для установки компьютера должна иметь отверстия для вентиляции в верхней и нижней части. Общая площадь отверстий не менее 40см ² . В шкафу, где предусматривается сейф, сейф устанавливается в левом отсеке, а компьютер в правом, так как сейф имеет правостороннюю дверь. На задней стенке отсека для компьютера предусматривается отверстие для розетки. Дверки шкафов должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия	Соответствие
4.18	Навесные шкафы (2.7) (2.8) должны иметь посередине полку из HPL толщиной не менее 12мм. Шкафы 2.7 должны иметь	Соответствие

	посередине вертикальную перегородку. Дверки шкафов должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия	
4.19	Приставной стол (2.9) одной стороной опирается на шкаф (2.6), другой стороной на регулируемые опоры. Столешница должна иметь закругленные углы. Размер столешницы стола 700x900 мм. Верх столешницы стола от должен быть в одной плоскости со столешницей шкафов	Соответствие
4.20	Цоколь (2.17) – высота цоколя 70-100 мм, регулируемая по горизонтальному уровню при помощи регулируемых опор. Цокольные планки выполняется из HPL – материалов толщиной не менее 10 мм. Высота цокольных планок равна высоте цоколя и подгоняется по месту	Соответствие
4.21	Ручки верхних ящиков и дверок низких шкафчиков изготавливаются из профиля 25x10 мм из нержавеющей стали, служащие также для временного подвеса различных принадлежностей. Остальные ручки выполняются в виде ручек-скоб из нержавеющей стали. Образцы ручек согласовать с эксплуатирующей организацией	Соответствие
4.22	Доборные элементы (2.16) служат стыковки фасадов модулей в местах образования углов, закрытие щелей примыкания к стенам, потолку, полу. Доборные элементы изготавливаются из HPL – материалов толщиной не менее 10 мм. Размеры доборных элементов определяются в конструкторской документации изготовителя	Соответствие
4.23	Вся применяемая фурнитура должна отвечать высоким требованиям по надежности при использовании на коммерческих объектах, не для бытового применения	Соответствие
4.24	Столешница (2.15) изготавливается с покрытием из HPL-плиты Trespa TopLab, толщиной не менее 12 мм или плиты из искусственного камня. Общая длина столешницы определяется согласно разработанной конструкторской документации. Общая толщина столешницы не менее 38-50 мм. Глубина столешницы 610-680мм. Задний край столешницы должен иметь борт высотой 40мм. Прилегание столешницы к вертикальным поверхностям стен и шкафов должны быть загерметизированы. В необходимых местах столешница должна иметь лючки для пропуска кабелей и проводов от оргтехники. Верх столешницы от уровня чистого пола должен быть в пределах 870-950мм.	Соответствие

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Комплект мебели индивидуального изготовления для постов медицинских сестер (для 4-го этажа)

№п/п	Наименование позиции/ Требуемые характеристики	Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру
1.	Наименование, количество и область применения	

1.1.	Наименование: Комплект функциональной модульной мебели индивидуального изготовления для постов медицинских сестер	Соответствие
1.2.	Количество, шт.	1
1.3.	Область применения: организованное хранение медикаментов и расходных материалов, обеспечение рабочих мест медицинских реанимационных сестер в отделении анестезиологии и реанимации	Соответствие
2.	Состав (комплектация одного комплекта) оборудования:	
2.1	Шкаф высокий с выдвижными ящиками с системами хранения, г.р. ШхГхВ (500-600х550х2000-2050) – 4 штуки	Наличие
2.2	Шкаф низкий с выдвижными ящиками с системами хранения, г.р. ШхГхВ (400-600х550х800) – 26 штук	Наличие
2.3	Шкаф низкий для встроенного холодильника, одностворчатый, г.р. ШхГхВ (500-600х550х800) – 4 штуки	Наличие
2.4	Шкаф низкий для встроенной мойки и мусорных контейнеров с двумя выдвижными створками, г.р. ШхГхВ (800-1000х550х800) – 3 штуки	Наличие
2.5	Шкаф низкий для встроенного умывальника и мусорных контейнеров с двумя выдвижными створками, г.р. ШхГхВ (800-1000х550х800) – 3 штуки	Наличие
2.6	Шкаф низкий, двустворчатый, г.р. ШхГхВ (900-1000х550х800) – 4 штуки	Наличие
2.7	Шкаф навесной, двустворчатый, г.р. ШхГхВ (800-1000х300-350х500) – 17 штук	Наличие
2.8	Шкаф навесной, одностворчатый, г.р. ШхГхВ (400-600х300-350х500) – 8 штук	Наличие
2.9	Стол приставной, г.р. ШхГхВ (900х700х850-900) – 4 шт уки	Наличие
2.10	Мойка с широкой чашей (типа Corian 881) – 3 штуки	Наличие
2.11	Комплект сантехнического оборудования для мойки: сифон из нержавеющей стали, с донным клапаном, с переливом; смеситель с высоким изливом, с вытягивающимся шлангом с лейкой, с термостатом (типа Grohetherm Micro); гибкие подводки холодной и горячей воды; кран для очищенной воды с поворотным S-образным изливом для установки в стену (типа FAR 11030.1-11030.2) – 3 комплекта	Наличие
2.12	Умывальник с узкой чашей (типа Corian 802) – 3 штуки	Наличие
2.13	Комплект сантехнического оборудования для умывальника: сифон из нержавеющей стали, с донным клапаном, с переливом; смеситель с локтевым или бесконтактным (на аккумуляторах) включением, с термостатом (типа Grohetherm Micro); гибкие подводки холодной и горячей воды – 3 комплекта	Наличие
2.14	Выдвижной модуль на 2 мусорных контейнера – 12 штук	Наличие
2.15	Столешница – 1 комплект	Наличие
2.16	Доборные элементы – 1 комплект	Наличие
2.17	Цоколь с высотой регулировки от 70 до 100мм – 1 комплект	Наличие
3.	Общие требования	
3.1	Инструкция по сборке и эксплуатации на русском языке	Наличие
3.2	Выполнение обмеров помещений за счет поставщика	Наличие
3.3	Конструкторскую документацию на изготовление выполняет производитель, с учетом фактических обмеров помещений	Наличие

3.4	Сборка и монтаж на объекте за счет поставщика	Наличие
3.5	Гарантийное обслуживание за счет поставщика	Не менее 24 месяцев
4.	Технические требования и характеристики:	
4.1	Мебельная сборка представляет собой комплект модульной мебели, состоящая из напольных и навесных шкафов, приставных столиков, оснащенных системами хранения, комплектом сантехнического оборудования. Примерная схема мебельных сборок приведена в Приложении 1. Ширина модулей может отличаться от схемы, в зависимости от реальных размеров помещения и применяемых систем хранения в ящиках	Соответствие
4.2	Корпусные детали и дно – из HPL толщиной не менее 12мм; цвета – светло-серый, белый или бежевый (по согласованию с Пользователем)	Соответствие
4.3	Задняя стенка – из HPL толщиной не менее 3мм, вставляется в канавки и привинчивается. Цвета – светло-серый, белый или бежевый (по согласованию с Пользователем)	Соответствие
4.4	Лицевые детали (фасад) – из HPL толщиной не менее 12мм. Канты фрезеруются в форме эллипса и полируются	Соответствие
4.5	Дно и задняя стенка выдвижного ящика – из HPL толщиной не менее 10мм. Глубина ящика не менее 500мм	Соответствие
4.6	Выдвижные ящики оснащаются системой роликовых телескопических направляющих полного выдвижения, со встроенным доводчиком, с расчетной нагрузкой 60кг. Допустимая нагрузка на каждый выдвижной ящик не менее 50 кг	Соответствие
4.7	Все ящики должны быть оснащены системами хранения - съемными лотками из ABS-пластика с переставляемыми разделителями	Соответствие
4.8	Верхние ящики низких шкафов должны быть оснащены замками. Ключ должен подходить ко всем замкам в группе шкафов одного поста медсестер (согласовать с эксплуатирующей организацией)	Соответствие
4.9	По периметру каждого ящика или двери должны быть предусмотрены силиконовые уплотнители, защищающие от попадания пыли	Соответствие
4.10	Двустворчатые шкаф должны иметь вертикальную перегородку из HPL толщиной не менее 12мм, разделяющую шкаф на два отсека	
4.11	Шкаф высокий (2.1) должен иметь 7 выдвижных ящика высотой 200-250 мм каждый. Над ящиками располагается одностворчатая ниша с двумя полками, разделяющими пространство ниши на равные части. Для герметичного притвора ящика необходимо наличие горизонтальных притворных планок, устанавливаемых заподлицо с горизонтальной плоскостью корпуса шкафа	Соответствие
4.12	Шкаф низкий (2.2) должен иметь 4 выдвижных ящика равной высоты. Для герметичного притвора ящика необходимо наличие горизонтальных притворных планок, устанавливаемых заподлицо с горизонтальной плоскостью корпуса шкафа	Соответствие

4.13	Шкаф для малогабаритного встраиваемого холодильника (2.3). Ориентировочные размеры холодильника ШхГхВ, не более: 540х540х820мм. Окончательные размеры шкафа уточняются у Заказчика на этапе разработки конструкторской документации. В случае превышения указанных размеров холодильника, по согласованию с Заказчиком, допускается установить холодильник в шкаф 2.1, а шкаф 2.3 заменить на шкаф, аналогичный 2.2. На задней стенке предусматривается отверстие для розетки	Соответствие
4.14	Шкаф для мойки (2.4) и умывальника (2.5) должны иметь выдвижные системы контейнеров для отходов – 2 ведра в каждом отсеке, объемом не менее 18л каждое. Выдвижные системы оснащаются системой роликовых телескопических направляющих полного выдвижения, со встроенным доводчиком, с расчетной нагрузкой 60кг. Выдвижение осуществляется совместно с дверью шкафа	Соответствие
4.15	Мойка с широкой чашей (2.10) предназначена для купания новорожденных, изготовлена из акрилового материала (типа Corian), иметь наклонные борта. Глубина мойки не менее 200мм, ширина 350-400мм, длина не менее 600мм. Способ монтажа – клеиваемая снизу. Модель мойки согласовать с эксплуатирующей организацией	Соответствие
4.16	Умывальник (2.12) предназначен для мойки рук, изготовлен из акрилового материала (типа Corian), иметь скругленные борта. Глубина умывальника не менее 100мм, ширина 250-300мм, длина не менее 400мм. Диаметр сливного отверстия 90мм. Способ монтажа – клеиваемая снизу. Модель умывальника согласовать с эксплуатирующей организацией	Соответствие
4.17	Шкаф (2.6) для размещения компьютера и сейфа с распашными дверцами, устанавливается на poste медицинских сестер. Дверь отсека для установки компьютера должна иметь отверстия для вентиляции в верхней и нижней части. Общая площадь отверстий не менее 40см ² . В шкафу, где предусматривается сейф, сейф устанавливается в левом отсеке, а компьютер в правом, так как сейф имеет правостороннюю дверь. На задней стенке отсека для компьютера предусматривается отверстие для розетки. Дверки шкафов должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия	Соответствие
4.18	Навесные шкафы (2.7) (2.8) должны иметь посередине полку из НРЛ толщиной не менее 12мм. Шкафы 2.7 должны иметь посередине вертикальную перегородку. Дверки шкафов должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия	Соответствие
4.19	Приставной стол (2.9) одной стороной опирается на шкаф (2.6), другой стороной на регулируемые опоры. Столешница должна иметь закругленные углы. Размер столешницы стола 700х900 мм. Верх столешницы стола от должен быть в одной плоскости со столешницей шкафов	Соответствие
4.20	Цоколь (2.17) – высота цоколя 70-100 мм, регулируемая по горизонтальному уровню при помощи регулируемых опор. Цокольные планки выполняется из НРЛ – материалов толщиной не менее 10 мм. Высота цокольных планок равна	Соответствие

	высоте цоколя и подгоняется по месту	
4.21	Ручки верхних ящиков и дверок низких шкафчиков изготавливаются из профиля 25x10 мм из нержавеющей стали, служащие также для временного подвеса различных принадлежностей. Остальные ручки выполняются в виде ручек-скоб из нержавеющей стали. Образцы ручек согласовать с эксплуатирующей организацией	Соответствие
4.22	Доборные элементы (2.16) служат стыковки фасадов модулей в местах образования углов, закрытие щелей примыкания к стенам, потолку, полу. Доборные элементы изготавливаются из HPL – материалов толщиной не менее 10 мм. Размеры доборных элементов определяются в конструкторской документации изготовителя	Соответствие
4.23	Вся применяемая фурнитура должна отвечать высоким требованиям по надежности при использовании на коммерческих объектах, не для бытового применения	Соответствие
4.24	Столешница (2.15) изготавливается с покрытием из HPL-плиты Trespa TopLab, толщиной не менее 12 мм или плиты из искусственного камня. Общая длина столешницы определяется согласно разработанной конструкторской документации. Общая толщина столешницы не менее 38-50 мм. Глубина столешницы 610-680мм. Задний край столешницы должен иметь борт высотой 40мм. Прилегание столешницы к вертикальным поверхностям стен и шкафов должны быть загерметизированы. В необходимых местах столешница должна иметь лючки для пропуска кабелей и проводов от оргтехники. Верх столешницы от уровня чистого пола должен быть в пределах 870-950мм.	Соответствие

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Комплект кухонной мебели индивидуального изготовления с электрической варочной панелью, со встроенной мойкой в комплекте со смесителем, сифоном, подводками (для молочного блока)

№п/п	Наименование позиции/ Требуемые характеристики	Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру
1.	Наименование, количество и область применения	
1.1.	Наименование: Комплект кухонной мебели индивидуального изготовления 3500x600x900 с электрической варочной панелью, со встроенной мойкой в комплекте со смесителем, сифоном, подводками	Соответствие
1.2.	Количество, шт.	1
1.3.	Область применения: организованное хранение кухонного инвентаря и продуктов в организациях здравоохранения	Соответствие
2.	Состав (комплектация одного комплекта) оборудования:	
2.1	Шкаф низкий с выдвигаемыми ящиками с системами хранения,	Наличие

	г.р. ШхГхВ (900x550x800) – 3 штуки	
2.2	Шкаф для встроенной мойки с двумя выдвижными створками, г.р. ШхГхВ (800x550x800) – 1 штука	Наличие
2.3	Шкаф навесной двухстворчатый, г.р. ШхГхВ (900x300-350x600) – 3 штуки	Наличие
2.4	Шкаф навесной двухстворчатый с комплектом для сушки посуды, г.р. ШхГхВ (800x300-350x600) – 1 штука	Наличие
2.5	Мойка двухсекционная – 1 штука	Наличие
2.6	Комплект сантехнического оборудования для мойки: сифон из нержавеющей стали, с донным клапаном, с переливом; смеситель с высоким изливом с вытягивающимся шлангом с лейкой; гибкие подводки холодной и горячей воды – 1 комплект	Наличие
2.6	Панель электрическая варочная 4-х конфорочная, накладная, поверхность из стеклокерамики – 1 штука	Наличие
2.7	Выдвижной модуль для мусорных контейнеров – 2 штуки	Наличие
2.8	Столешница – 1 комплект	Наличие
2.9	Доборные элементы – 1 комплект	Наличие
2.10	Цоколь – 1 комплект	Наличие
2.11	Скинали – 1 шт	Наличие
3.	Общие требования	
3.1	Инструкция по сборке и эксплуатации на русском языке	Наличие
3.2	Конструкторскую документацию на изготовление выполняет производитель, с учетом фактических обмеров помещений	Наличие
3.3	Сборка и монтаж на объекте за счет поставщика	Наличие
3.4	Гарантийное обслуживание за счет поставщика	Не менее 24 месяцев
4.	Технические требования и характеристики:	
4.1	Мебельная сборка представляет собой комплект модульной мебели, состоящая из напольных и навесных шкафов, оборудованные системами хранения, варочной поверхностью	Соответствие
4.2	Корпусные детали и дно – из плиты ЛДСтП толщиной не менее 18мм, окантованных противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм; цвета - светло-серый, белый или бежевый (по согласованию с эксплуатирующей организацией). Цвет кромки корпуса – в цвет фасада	Соответствие
4.3	Задняя стенка – из плиты ХДФ толщиной не менее 3мм, вставляется в канавки и привинчивается. Цвета – светло-серый, белый или бежевый (по согласованию с эксплуатирующей организацией)	Соответствие
4.4	Скинали – из плиты ХДФ толщиной не менее 3мм, Цвет – декоративный (тип согласовать с эксплуатирующей организацией)	Соответствие
4.5	Лицевые детали (фасад) – из HPL толщиной не менее 12мм. Канты фрезеруются в форме эллипса и полируются	Соответствие
4.6	Шкаф низкий (2.1) должен иметь 3 выдвижных ящика. Размеры ящиков по фасаду: верхний ящик высотой 150мм – для хранения кухонной мелочи. Средний ящик высотой 250мм. Нижний ряд ящиков высотой 400мм	Соответствие
4.7	Выдвижные ящики изготавливаются из: боковины – металлические с реллингами, дно – из плиты ЛДСтП толщиной не менее 16мм. Глубина ящика не менее 500мм. Допустимая	Соответствие

	нагрузка на средний и нижний выдвижной ящик не менее 50 кг, на верхний ящик – 30 кг	
4.8	Выдвижные ящики оснащаются системой роликовых телескопических направляющих полного выдвижения, со встроенным доводчиком, с расчетной нагрузкой 60кг	Соответствие
4.9	Все ящики должны быть оснащены системами хранения - съемными лотками из ABS-пластика с переставляемыми разделителями	Соответствие
4.10	Навесные шкафы должны иметь посередине вертикальную перегородку и одну неподвижную полку в каждом отсеке. Допустимая нагрузка на каждую полку не менее 15 кг. Двери шкафа должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия	Соответствие
4.11	Шкаф для мойки (2.2) должны иметь выдвижные системы контейнеров для отходов – 2 ведра, объемом не менее 18л каждое, лотками для принадлежностей. Выдвижные системы оснащаются системой роликовых телескопических направляющих полного выдвижения, со встроенным доводчиком, с расчетной нагрузкой 60кг. Выдвижение осуществляется совместно с дверью шкафа	Соответствие
4.12	Мойка двухсекционная (2.5) должна быть изготовлена из композитной керамики. Размеры каждой ванны: глубина не менее 180мм, ширина 350-400мм, длина не менее 300мм. Способ монтажа – клеиваемая снизу. Модель мойки согласовать с эксплуатирующей организацией	Соответствие
4.13	Цоколь – высота цоколя 70-100 мм, регулируемая по горизонтальному уровню при помощи регулируемых опор. Цокольные планки выполняется из HPL – материалов толщиной не менее 10 мм, иметь герметизирующий уплотнитель примыкания к напольному покрытию	Соответствие
4.14	Ручки ящиков и дверок шкафчиков – релинговые из нержавеющей стали. Образцы ручек согласовать с эксплуатирующей организацией	Соответствие
4.15	Доборные элементы служат стыковки фасадов модулей в местах образования углов, закрытие щелей примыкания к стенам, полу. Доборные элементы изготавливаются из HPL – материалов толщиной не менее 10 мм. Размеры доборных элементов определяются в конструкторской документации изготовителя	Соответствие
4.16	Вся применяемая фурнитура должна отвечать высоким требованиям по надежности при использовании на коммерческих объектах, не для бытового применения	Соответствие
4.17	Столешница изготавливается с покрытием из композитной керамики типа FRIDURIT, толщиной не менее 12 мм. Общая длина столешницы определяется согласно разработанной конструкторской документации. Общая толщина столешницы не менее 38-50 мм. Глубина столешницы 610-680мм. Задний край столешницы должен иметь борт высотой 40мм. Прилегание столешницы к вертикальным поверхностям стен должны быть загерметизированы. Верх столешницы от уровня чистого пола должен быть в пределах 870-950мм.	Соответствие

4.18	Панель электрическая варочная 4-х конфорочная, накладная, поверхность из стеклокерамики, с сенсорным управлением, наличие таймера со звуковым оповещением, индикатором остаточного тепла, мощностью не более 5,5кВт	Соответствие
------	---	--------------

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Комплект кухонной мебели индивидуального изготовления со встроенной мойкой в комплекте со смесителем, сифоном, подводками

№п/п	Наименование позиции/ Требуемые характеристики	Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру
1.	Наименование, количество и область применения	
1.1.	Наименование: Комплект кухонной мебели индивидуального изготовления 1800х600х900 со встроенной мойкой в комплекте со смесителем, сифоном, подводками	Соответствие
1.2.	Количество, шт.	1
1.3.	Область применения: организованное хранение кухонного инвентаря и продуктов в организациях здравоохранения	Соответствие
2.	Состав (комплектация одного комплекта) оборудования:	
2.1	Шкаф низкий с выдвижными ящиками с системами хранения, г.р. ШхГхВ (900х550х800) – 1 штука	Наличие
2.2	Шкаф для встроенной мойки с двумя выдвижными створками, г.р. ШхГхВ (900х550х800) – 1 штука	Наличие
2.3	Шкаф навесной двухстворчатый (ширина 900мм, глубина 350мм, высота 600мм) – 2 штуки	Наличие
2.4	Мойка односекционная – 1 штука	Наличие
2.5	Комплект сантехнического оборудования для мойки: сифон из нержавеющей стали, с донным клапаном, с переливом; смеситель с высоким изливом; гибкие подводки холодной и горячей воды; – 1 комплект	Наличие
2.6	Выдвижной модуль на 2 мусорных контейнера – 2 штуки	Наличие
2.7	Столешница – 1 комплект	Наличие
2.8	Доборные элементы – 1 комплект	Наличие
2.9	Цоколь – 1 комплект	Наличие
2.10	Скинали – 1 штука	Наличие
3.	Общие требования	
3.1	Инструкция по сборке и эксплуатации на русском языке	Наличие
3.2	Конструкторскую документацию на изготовление выполняет производитель, с учетом фактических обмеров помещений	Наличие
3.3	Сборка и монтаж на объекте за счет поставщика	Наличие
3.4	Гарантийное обслуживание за счет поставщика	Не менее 24 месяцев
4.	Технические требования и характеристики:	
4.1	Мебельная сборка представляет собой комплект модульной мебели, состоящая из напольных и навесных шкафов, оборудованные системами хранения	Соответствие
4.2	Корпусные детали и дно – из плиты ЛДСП толщиной не	Соответствие

	менее 18мм; цвета - светло-серый, белый или бежевый (по согласованию с эксплуатирующей организацией). Цвет кромки корпуса – в цвет фасада	
4.3	Задняя стенка – из плиты ХДФ толщиной не менее 3мм, вставляется в канавки и привинчивается. Цвета – светло-серый, белый или бежевый (по согласованию с эксплуатирующей организацией)	Соответствие
4.4	Скинали – из плиты ХДФ толщиной не менее 3мм, Цвет – декоративный (тип согласовать с эксплуатирующей организацией)	Соответствие
4.5	Лицевые детали (фасад) – из плиты ЛДСтП, толщиной не менее 18мм, окантованных противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм	Соответствие
4.6	Шкаф низкий (2.1) должен иметь 3 выдвижных ящика. Размеры ящиков по фасаду: верхний ящик высотой 150мм – для хранения кухонной мелочи. Средний ящик высотой 250мм. Нижний ряд ящиков высотой 400мм	Соответствие
4.7	Выдвижные ящики изготавливаются из: боковины – металлические с реллингами, дно – из плиты ЛДСтП толщиной не менее 16мм. Глубина ящика не менее 500мм. Допустимая нагрузка на средний и нижний выдвижной ящик не менее 50 кг, на верхний ящик – 30 кг	Соответствие
4.8	Выдвижные ящики оснащаются системой роликовых телескопических направляющих полного выдвижения, со встроенным доводчиком, с расчетной нагрузкой 60кг	Соответствие
4.9	Все ящики должны быть оснащены системами хранения - съемными лотками из ABS-пластика с переставляемыми разделителями	Соответствие
4.10	Навесные шкафы должны иметь посередине вертикальную перегородку и одну неподвижную полку в каждом отсеке. Допустимая нагрузка на каждую полку не менее 15 кг. Двери шкафа должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия	Соответствие
4.11	Шкаф для мойки (2.2) должны иметь выдвижные системы контейнеров для отходов – 2 ведра, объемом не менее 18л каждое, лотками для принадлежностей. Выдвижные системы оснащаются системой роликовых телескопических направляющих полного выдвижения, со встроенным доводчиком, с расчетной нагрузкой 60кг. Выдвижение осуществляется совместно с дверью шкафа	Соответствие
4.12	Мойка односекционная (2.4) должна быть изготовлена из композитной керамики. Размеры ванны: глубина не менее 180мм, ширина 350-400мм, длина не менее 300мм. Способ монтажа – клеиваемая снизу. Модель мойки согласовать с эксплуатирующей организацией	Соответствие
4.13	Цоколь – высота цоколя 70-100 мм, регулируемая по горизонтальному уровню при помощи регулируемых опор. Цокольные планки выполняется из ПВХ, иметь герметизирующий уплотнитель примыкания к напольному покрытию	Соответствие
4.14	Ручки ящиков и дверок шкафчиков – реллинговые из нержавеющей стали. Образцы ручек согласовать с эксплуатирующей организацией	Соответствие

4.15	Доборные элементы служат стыковки фасадов модулей в местах образования углов, закрытие щелей примыкания к стенам, полу. Доборные элементы изготавливаются из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм. Размеры доборных элементов определяются в конструкторской документации изготовителя	Соответствие
4.16	Вся применяемая фурнитура должна отвечать высоким требованиям по надежности при использовании на коммерческих объектах, не для бытового применения	Соответствие
4.17	Столешница изготавливается с покрытием из композитной керамики типа FRIDURIT, толщиной не менее 12 мм. Общая длина столешницы определяется согласно разработанной конструкторской документации. Общая толщина столешницы не менее 38-50 мм. Глубина столешницы 610-680мм. Задний край столешницы должен иметь борт высотой 40мм. Прилегание столешницы к вертикальным поверхностям стен должны быть загерметизированы. Верх столешницы от уровня чистого пола должен быть в пределах 870-950мм.	Соответствие

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шкаф-кровать индивидуального изготовления, откидная

№п/п	Наименование позиции/ Требуемые характеристики	Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру
1.	Наименование, количество и область применения	
1.1.	Наименование: Шкаф-кровать индивидуального изготовления, откидная, с антресолюю	Соответствие
1.2.	Количество, шт.	4
1.3.	Область применения: организация временного спального места в организациях здравоохранения	Соответствие
2.	Состав (комплектация одного комплекта) оборудования:	
2.1	Шкаф-кровать с антресолюю – 1 штука	Наличие
2.2	Ложе – 1 штука	Наличие
2.3	Матрас с намотрасником – 1 штука	Наличие
3.	Общие требования	
3.1	Инструкция по сборке и эксплуатации на русском языке	Наличие
3.2	Конструкторскую документацию на изготовление выполняет производитель, с учетом фактических обмеров помещений	Наличие
3.3	Сборка и монтаж на объекте за счет поставщика	Наличие
3.4	Гарантийное обслуживание за счет поставщика	Не менее 24 месяцев
4.	Технические требования и характеристики:	
4.1	Шкаф-кровать представляет собой шкаф-трансформер на одно спальное место, в комплекте с матрацем	Соответствие
4.2	В сложенном состоянии шкаф-кровать должен представлять собой элемент стеновых ограждающих конструкций чистых помещений и иметь непрерывную поверхность от пола до	Соответствие

	потолка (ориентировочно высота потолка 2750мм)	
4.3	Корпусные детали и дно шкафа – из HPL толщиной не менее 12мм; цвета – светло-серый, белый или бежевый (по согласованию с Пользователем)	Соответствие
4.4	Задняя стенка – из HPL толщиной не менее 3мм, вставляется в канавки и привинчивается. Цвета – светло-серый, белый или бежевый (по согласованию с Пользователем)	Соответствие
4.5	Лицевые детали (фасад) – из HPL толщиной не менее 12мм. Канты фрезеруются в форме эллипса и полируются	Соответствие
4.6	Ложе кровати – из деревянных ламелей. Размеры спального места (Д x Ш): 2000 x 900 мм	Соответствие
4.7	Цоколь – высота цоколя 100 мм, регулируемая по горизонтальному уровню при помощи регулируемых опор. Цокольные планки выполняется из HPL – материалов толщиной не менее 10 мм	Соответствие
4.8	Антресоль с двумя распашными дверями, иметь вертикальную перегородку, разделяющая пространство на две равных части. Антресоль предназначена для хранения мягкого инвентаря	Соответствие
4.9	По периметру дверей должны быть предусмотрены силиконовые уплотнители, защищающие от попадания пыли	Соответствие
4.10	Доборные элементы – из HPL – материалов толщиной не менее 10 мм	Соответствие
4.11	Вся применяемая фурнитура должна отвечать высоким требованиям по надежности при использовании на коммерческих объектах, не для бытового применения	Соответствие
4.12	Допустимая нагрузка на кровать не менее 150 кг	Соответствие
4.13	Размер шкафа-кровати в сложенном положении (В x Ш x Г) с антресолью и цоколем не более: 2750 x 1100 x 300 мм	Соответствие
4.14	Матрас должен быть с намотасником, который позволяет проводить дезинфекционную обработку	Соответствие

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шкаф одностворчатый, индивидуального изготовления с отделением для встроенного холодильника, печи СВЧ, полками для хранения, с вентилируемой задней стенкой

№п/п	Наименование позиции/ Требуемые характеристики	Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру
1.	Наименование, количество и область применения	
1.1.	Наименование: Шкаф одностворчатый, индивидуального изготовления с отделением для встроенного холодильника, печи СВЧ, полками для хранения, с вентилируемой задней стенкой	Соответствие
1.2.	Количество, шт.	4
1.3.	Область применения: организованное хранение инвентаря и расходных материалов в организациях здравоохранения	Соответствие

2.	Состав (комплектация одного комплекта) оборудования:	
2.1	Шкаф высокий для встроенной бытовой техники, г.р. ШХГхВ (600х600х2500) – 1 штука	Наличие
2.2	Доборные элементы – 1 комплект	Наличие
2.3	Цоколь с высотой регулировки от 70 до 100мм – 1 комплект	Наличие
3.	Общие требования	
3.1	Инструкция по сборке и эксплуатации на русском языке	Наличие
3.2	Выполнение обмеров помещений за счет поставщика	Наличие
3.3	Конструкторскую документацию на изготовление выполняет производитель, с учетом фактических обмеров помещений	Наличие
3.4	Сборка и монтаж на объекте за счет поставщика	Наличие
3.5	Гарантийное обслуживание за счет поставщика	Не менее 24 месяцев
4.	Технические требования и характеристики:	
4.1	Мебельная сборка представляет собой комплект модульной мебели, состоящая из напольного шкафа, оборудованного системами хранения. Примерная схема шкафа приведена на рисунке ниже. Размеры шкафа могут отличаться от схемы, в зависимости от реальных размеров помещения	Соответствие
4.2	Корпусные детали и дно – из HPL толщиной не менее 12мм; цвета – светло-серый, белый или бежевый (по согласованию с Пользователем)	Соответствие
4.3	Задняя стенка – из HPL толщиной не менее 3мм, вставляется в канавки и привинчивается. Цвета – светло-серый, белый или бежевый (по согласованию с Пользователем). На задней стенке, в необходимых местах предусматриваются отверстия для розеток	Соответствие
4.4	Лицевые детали (фасад) – из HPL толщиной не менее 12мм. Канты фрезеруются в форме эллипса и полируются	Соответствие
4.5	Шкаф высокий (2.1) должен иметь: нишу высотой 950мм для малогабаритного холодильника, 2 выдвижных ящика высотой 200 мм каждый; нишу высотой 400 мм с дверью для микроволновой печи; нишу высотой 350 мм с дверью для хранения личных вещей; антресоль высотой 600мм, разделенная полкой на два равных отсека для хранения белья	Соответствие
4.6	Выдвижные ящики оснащаются системой роликовых телескопических направляющих полного выдвижения, со встроенным доводчиком, с расчетной нагрузкой 60кг. Допустимая нагрузка на каждый выдвижной ящик не менее 50 кг	Соответствие
4.7	Все ящики должны быть оснащены системами хранения - съемными лотками из ABS-пластика с переставляемыми разделителями	Соответствие
4.8	По периметру каждого ящика или двери должны быть предусмотрены силиконовые уплотнители, защищающие от попадания пыли	Соответствие
4.9	Ящики шкафа должны быть оснащены замками. Ключ должен подходить ко всем замкам в составе шкафа	Соответствие
4.10	Распашные двери шкафа должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия	Соответствие
4.11	Цоколь – высота цоколя 70-100 мм, регулируемая по	Соответствие

	горизонтальному уровню при помощи регулируемых опор. Цокольные планки выполняются из HPL – материалов толщиной не менее 10 мм. Высота цокольных планок равна высоте цоколя и подгоняется по месту	
4.12	Ручки верхнего ящика изготавливаются из профиля 25x10 мм из нержавеющей стали, служащие также для временного подвеса различных принадлежностей. Остальные ручки выполняются в виде ручек-скоб из нержавеющей стали. Образцы ручек согласовать с эксплуатирующей организацией	Соответствие
4.13	Доборные элементы (2.2) служат стыковки фасадов модулей в местах образования углов, закрытие щелей примыкания к стенам, потолку, полу. Доборные элементы изготавливаются из HPL – материалов толщиной не менее 10 мм. Размеры доборных элементов определяются в конструкторской документации изготовителя	Соответствие
4.14	Вся применяемая фурнитура должна отвечать высоким требованиям по надежности при использовании на коммерческих объектах, не для бытового применения	Соответствие

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


Система подготовки очищенной воды по принципу «Обратный осмос» в комплекте

№п/п	Наименование позиции/ Требуемые характеристики	Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру
1.	Наименование, количество и область применения	
1.1.	Наименование: Система подготовки очищенной воды по принципу «Обратный осмос»	Соответствие
1.2.	Количество, штук/комплектов	1 комплект
1.3.	Область применения: система предназначена для очистки водопроводной воды от механических частиц, растворенных солей, бактерий, эндотоксинов и подачи очищенной воды к потребителям (моющие машины, паровые стерилизаторы) под давлением 0,2-0,6 МПа.	Соответствие
2.	Состав (комплектация одной системы) оборудования:	
2.1	Блок предварительной очистки - 1 комплект, в составе:	Наличие
2.1.1	Механической фильтр грубой очистки, ячейка 10-100мкм, с функцией обратной промывки – 1 штука	Наличие
2.1.2	Фильтр удаления железа с электронным блоком контроля и управления – 1 штука	Наличие
2.1.3	Угольный фильтр с электронным блоком контроля и управления – 1 штука	Наличие
2.1.4	Блок умягчения воды с цифровым управлением (микропроцессорным блоком контроля) – 1 штука	Наличие
2.1.5	Механический фильтр тонкой очистки, ячейка 1-10мкм – 1 штука	Наличие
2.2	Станция обратного осмоса - 1 комплект, в составе:	Наличие
2.2.1	Станция высокого давления – 1 штука	Наличие
2.2.2	Блок управления станцией – 1 штука	Наличие

2.3	Накопительный бак на 400 литров со станцией повышения давления для воды с проводимостью 5mS/см, с защитой от сухого хода - 1 комплект	Наличие
2.4	Стартовый комплект расходных материалов - 1 комплект, в составе:	Наличие
2.4.1	Картриджи тонкой очистки 1-10 мкм – 10 штук	Наличие
2.4.2	Сменная засыпка для угольного фильтра – 20 л (или 4 картриджа)	Наличие
2.4.3	Сменная засыпка для фильтра по железу – 50 л (или 4 картриджа)	Наличие
2.4.4	Соль таблетированная для смягчителя – 100 кг	Наличие
1.5	Трубопроводы ПВХ, краны, фитинги и трубопроводная арматура, и крепление для обвязки всей системы – 1 комплект	Наличие
1.6	Соединительные кабели и провода, штекеры для монтажа всей системы в необходимом количестве – 1 комплект	Наличие
3.	Общие требования	
3.1	Инструкция пользователя и монтажный план на русском языке	Наличие
3.2	Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь	Наличие
3.3	Установка (инсталляция) оборудования входит в стоимость оборудования и выполняется представителем поставщика	Наличие
3.4	Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика	Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
3.5	Обучение персонала, в количестве не менее 2-х человек, работе на аппарате после инсталляции оборудования	Наличие
3.6	При монтаже Поставщик должен подключить всю систему от силового щитка в помещении	Наличие
4.	Технические требования и характеристики:	
4.1	Система водоочистки, должна обеспечивать удаление более 95% растворенных солей и более 99% бактерий и эндотоксинов из очищаемой воды с максимальным коэффициентом использования воды 70%	Соответствие
4.2	Система должна иметь накопительный бак для очищенной воды емкостью не менее 400 литров и двухнасосную станцию для подачи очищенной воды к местам ее потребления под давлением 0,2-0,6МПа с потоком не менее 80 л/мин.	Соответствие
4.3	Станция обратного осмоса должна производить не менее 200 л/ч очищенной воды при давлении входной воды 0,2МПа и температуре + 5°С.	Соответствие
4.4	Станция обратного осмоса должна быть выполнена в шкафном исполнении в звукоизолирующем корпусе. Шкаф должен иметь переднюю панель в виде двери для быстрого	Соответствие


	доступа к внутренним узлам. Для открытия двери не должен требоваться дополнительный инструмент. Габариты шкафа в пределах (ВхШхГ): 2050x850x450 мм.	
4.5	Система должна оснащаться фильтром для удаления из входной воды мелких (1-10 мкм) механических частиц, окислов железа и угольным фильтром	Соответствие
4.6	Водоочистка должна оснащаться системой смягчения входной воды, которая обеспечивает подачу смягченной воды и регенерацию в автоматическом режиме. Управление системой смягчителя воды осуществляется микропроцессорным блоком контроля	Соответствие
4.7	Система должна иметь кран отбора смягченной воды питьевого качества для наполнения бутылей	Соответствие
4.8	Станция обратного осмоса должен контролировать проводимость выходной. При выходе этого параметра за допустимые пределы должно генерироваться сообщение об ошибке	Соответствие
4.9	Станция обратного осмоса должна иметь режим химической дезинфекции, не требующий для ее проведения дополнительных подсоединений или переключений трубопроводов. Вход и выход из режима дезинфекции должен осуществляться программно через сервисный режим	Соответствие
4.10	Все составные части системы водоочистки должны оборудоваться простыми в управлении обходными клапанами, выполненными в виде единого блока, позволяющими обеспечить работоспособность всей системы в целом при выходе из строя одной из ее частей	Соответствие
4.11	Входное напряжение для инсталляции 380 Вольт, установленная мощность не более 4,5 кВт	Соответствие
4.12	Габаритные размеры должны позволять перемещать оборудование в разобранном виде через дверной проем шириной 800мм в свету, высотой 2000мм в свету	Соответствие

Шкаф Ш-18

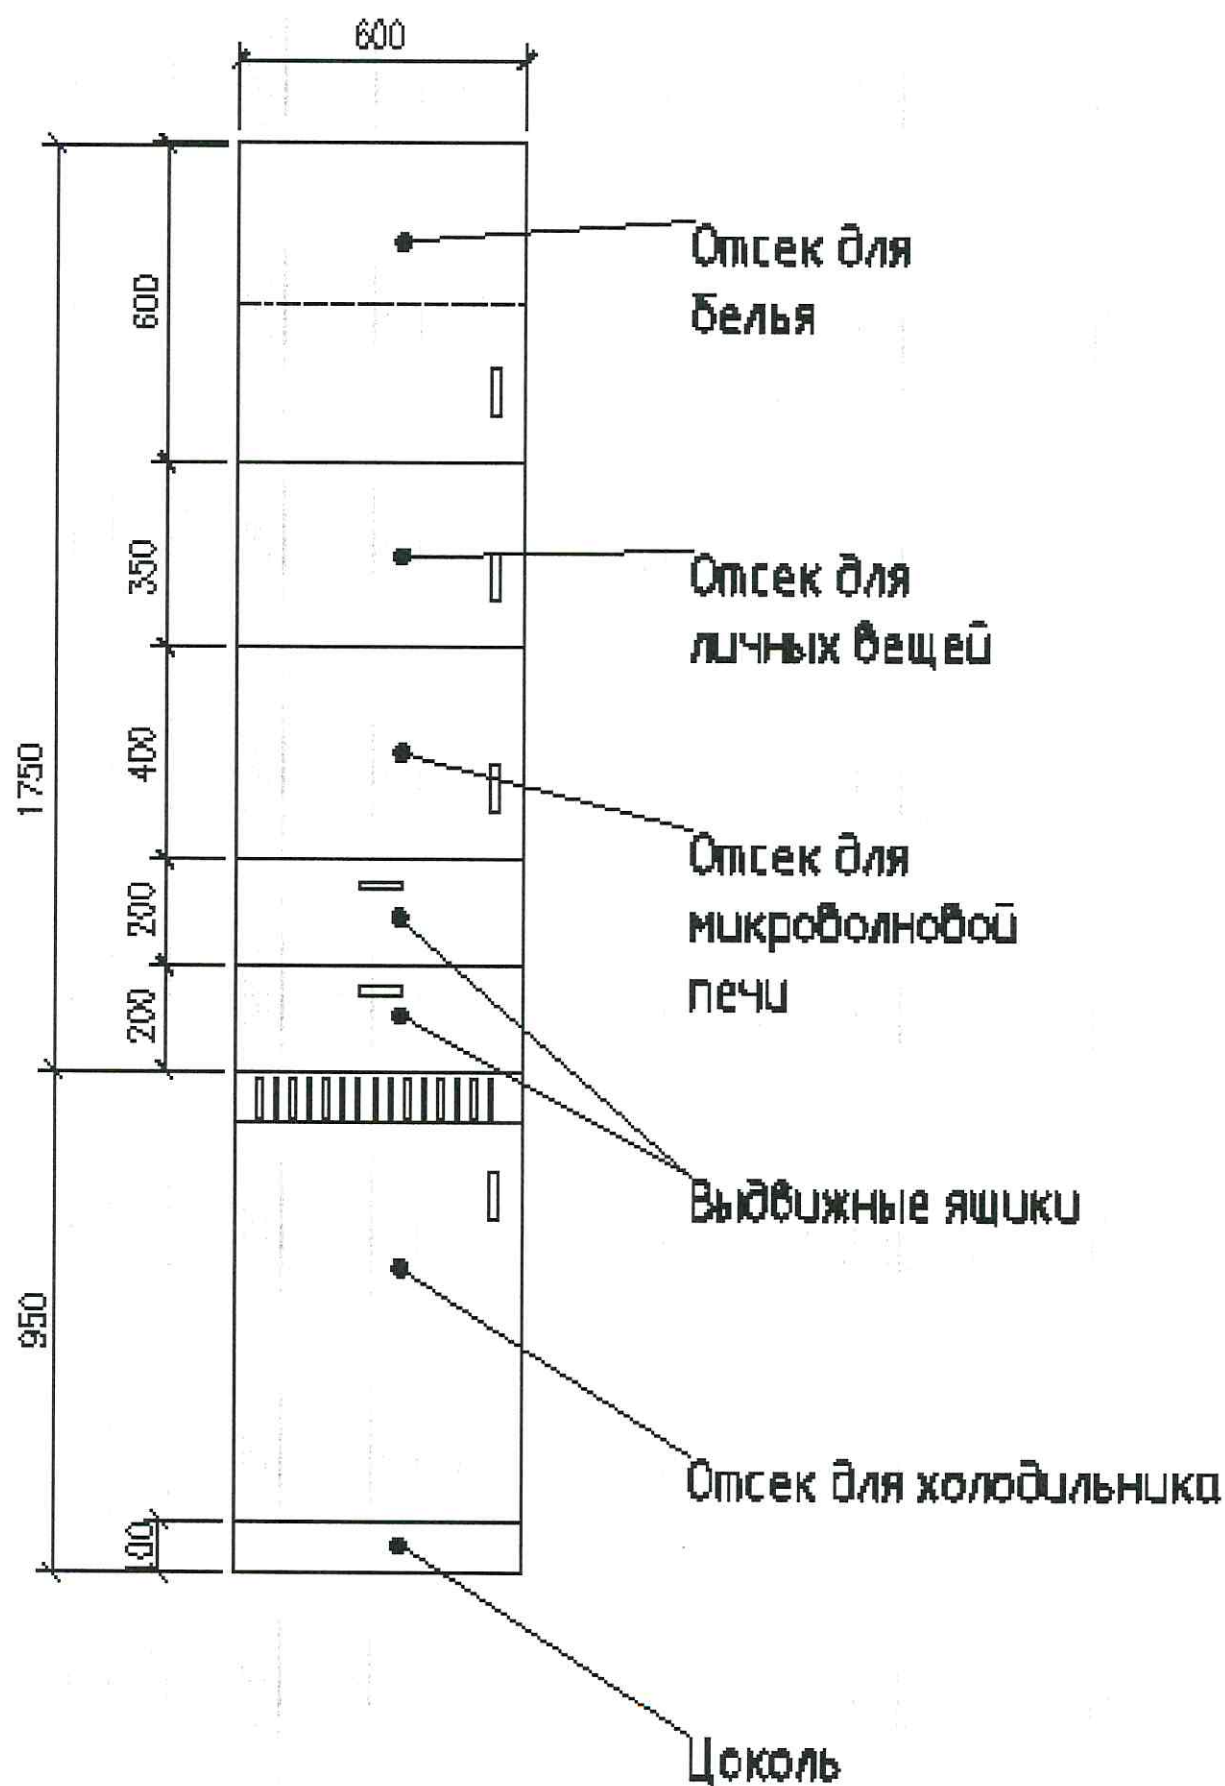


Приложение 1 Эскизы мебели

Мебельная сборка постов медицинских сестер в помещении №1
2-го и 3-го этажей

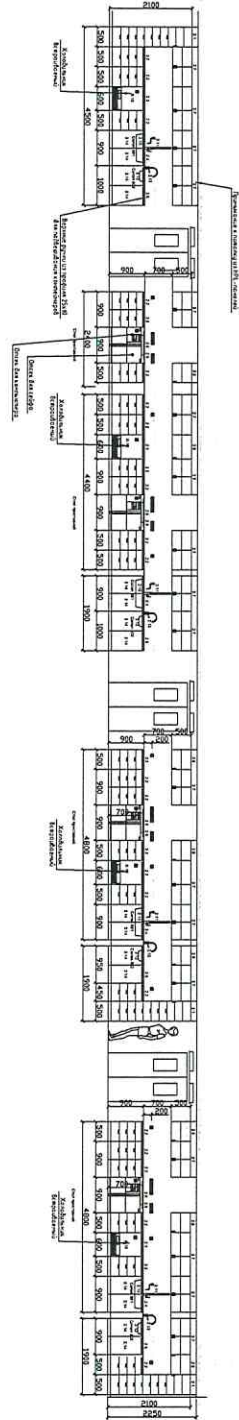

Мебельная сборка постов медицинских сестер в помещении №1
4-го этажа

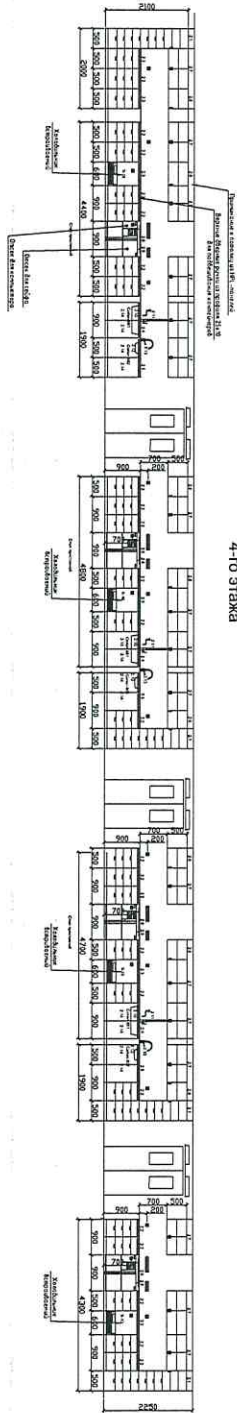

Форма подачи Ценового Предложения

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим предлагаем поставить товары согласно списку, приведенного ниже, в соответствии с техническим заданием Приложения 1

№ п/п	Описание/ спецификация товар	Кол-во, ед. изм.	Цена за единицу (без НДС)	Общая стоимость (без НДС)
1				
2				
3				
4				
5				
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ (ЦИФРАМИ И СЛОВАМИ):			
	Условия поставки			г. Минск, ул. Орловская, 66
	Валюта предложения			Белорусские рубли
	Срок доставки			30-90 дней календарных дней с даты подписания контракта
	Срок действия предложения (не менее 120 дней)			

ФИО и подпись уполномоченного лица
 Должность уполномоченного лица
 Дата

Информационная форма участника

1	Наименование юридического лица/предпринимателя:	
2	Адрес:	
3	Телефон:	
4	Адрес электронной почты:	
5	Факс:	
6	Место и год регистрации:	
7	Наименование организации, выдавшей регистрационное удостоверение:	
8	ФИО, должность руководителя компании/организации:	
9	Контактное лицо по настоящему предложению:	
10	Банковские реквизиты:	
11	Наличие опыта работы компании-претендента на рынке поставок компьютерного оборудования и программного обеспечения для государственных организаций не менее 3-х лет	
12	Информация о том, что организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации, либо индивидуальный предприниматель не находится в стадии прекращения деятельности, или не признаны в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельными (банкротами), за исключением находящихся в процедуре санации	
13	согласие участника выполнить условия проекта договора	

ФИО и подпись уполномоченного лица
 Должность уполномоченного лица
 Дата

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № G 3.5

г. Минск

«__» _____ 2020г.

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения», в лице директора Сачек Марины Михайловны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», и _____ в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Продавец», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю _____ (далее - Товар) в ассортименте, количестве и по цене в соответствии со спецификацией согласно приложению 1 к Договору, которое является его неотъемлемой частью, произвести сборку и его монтаж, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

1.2. Цель приобретения Товара: реализация проекта «Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь», финансируемого за счет средств Займа Международного Банка реконструкции и развития (далее - МБРР) № 8663-ВУ.

1.3. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору Поставщик обязуется предоставить Покупателю банковскую гарантию в течение 28 календарных дней после получения извещения о принятии конкурсного предложения.

Срок действия банковской гарантии – с момента ее выдачи и по истечении 28 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ согласно условиям настоящего Договора. Сумма банковской гарантии определяется из расчета 10 (десяти) процентов от общей стоимости поставляемого Товара.

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость Товара по Договору с учетом сборки и монтажа, составляет – _____ без НДС согласно подпункту 5.3 Распоряжения Президента Республики Беларусь от 21.08.2017 № 135рп «О реализации Соглашения о займе».

2.2. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки включается в стоимость Товара.

2.3. Покупатель производит оплату Товара по факту его сборки и монтажа на основании акта выполненных работ путем перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в размере 100 % от стоимости поставленного Товара в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поставки при условии передачи Покупателю оригинала банковской гарантии в соответствии с п. 1.3. Договора.

2.4. Источник финансирования: средства Займа МБРР № 8663-ВУ по проекту «Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь».

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Товар должен быть передан Покупателю в течение 30-90 (от тридцати до девяноста) календарных дней с даты подписания Договора.

3.2. Упаковка, в которой передается Товар, должна соответствовать установленным в стране Продавца стандартам или техническим условиям, а также обеспечивать сохранность Товара и защиту от атмосферных воздействий.

3.3. Доставка Товара Покупателю осуществляется за счет средств и силами Продавца в пункт конечного назначения: г. Минск, ул. Орловская, 66.

3.4. Дата поставки Товара считается дата подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной (товарно-транспортной) накладной на поставленный Товар.

3.5. Приемка товара осуществляется Покупателем в соответствии с Положением о приемке товара по количеству и качеству, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 №1290.

3.6. Продавец обязуется произвести замену некачественного Товара либо некомплектного Товара в срок не позднее 14 (четырнадцати) банковских дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям, иным обязательным требованиям к качеству, оговоренным в Договоре, и подтверждаться оригинальными документами по качеству и иным требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь.

4.2. Поставщик несет ответственность за качество Товара. В случае поставки некачественного и (или) некомплектного Товара, Поставщик в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента получения извещения Покупателя обязуется заменить некачественный и (или) некомплектный Товар, а при невозможности его замены в указанный срок, возместить Покупателю стоимость некачественного и (или) некомплектного Товара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

5.2. За нарушение срока поставки Товара, указанного в пункте 3.1 Договора, Продавец уплачивает Покупателю пени в размере 0,15% стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, которые могут возникнуть по Договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров он передается на рассмотрение в Экономический суд г. Минска.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются события, возникшие после заключения Договора и не зависящие от воли Сторон (пожары, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия), а также иные обстоятельства, которые в установленном законодательством Республики Беларусь порядке будут признаны обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана немедленно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влияние на исполнение Договора.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на срок исполнения обязательств по Договору, то этот срок соразмерно продлевается на время действия этого обязательства, если Стороны не примут решения о прекращении действия Договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления Продавцу письменного уведомления о таком расторжении в случае непредставления Продавцом банковской гарантии в соответствии с п. 1.3. Договора.

8.2. Изменение условий Договора возможно путем подписания обеими сторонами дополнительного соглашения к Договору.

8.3. В случаях, не предусмотренных Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

8.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

8.5. Договор, все дополнения и изменения к нему, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу с последующим обменом оригиналами.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель:

Государственное учреждение
«Республиканский научно-практический
центр медицинских технологий,
информатизации, управления и экономики
здравоохранения»

220013, г. Минск, ул. П. Бровки 7А
р/с BY13BLBV36200100185223001002
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской обл.,
ул. Коллекторная, 11
БИК BLBVBV2X, УНП 100185223

Директор

_____ М.М.Сачек

Продавец:

_____ / _____ /

Гарантия выполнения контракта (Банковская гарантия)

[Фирменный бланк Гаранта или код SWIFT]

Бенефициар:

Дата: [Вставьте дату выдачи].....

Гарантия выполнения контракта No.: [Вставьте номер гарантии].....

Гарант: [Вставьте наименование и адрес места выдачи, если не указано на фирменном бланке]

Мы были проинформированы о том, что [наименование Подрядчика, в случае консорциума – наименование консорциума] (именуемый в дальнейшем “Заявитель”) заключил Контракт No. [вставьте номер контракта] от [вставьте дату] с Бенефициаром на выполнение [вставьте наименование контракта и краткое описание Объекта] (в дальнейшем именуемый “Контракт”).

Кроме того, мы понимаем, что, согласно условиям Контракта, требуется гарантия выполнения контракта.

По просьбе Заявителя, мы, как Гарант, настоящим берём на себя безусловное и не подлежащее отмене обязательство выплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в совокупности [наименование валюты и сумма цифрами]¹ ([сумма прописью]) причем эта сумма подлежит выплате в тех валютах и том их пропорциональном соотношении, в которых выплачивается Стоимость Контракта, по первому письменному требованию Бенефициара, с приложением письменного уведомления о том, что Заявитель нарушил своё обязательство(а) по Контракту, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснования требования о выплате определённой в данном документе суммы.

Срок действия данной гарантии истекает не позднее, чем, [дата, месяц, год]², и любое требование платежа по данной гарантии должно быть получено нами в офисе в эту или более раннюю дату. Настоящая Гарантия попадает под действие Единых Правил для Гарантий по Требованию, редакция 2010, опубликованных в Документе No 758 Международной Торговой Палаты, кроме вспомогательного пункта Параграфа 15(а), который исключается настоящим. [подпись(-и)]

Примечание – Текст курсивом (включая сноски) является вспомогательным для заполнения данной гарантии и его следует удалить из окончательного варианта документа.

¹ Гарант должен вставить сумму, отражающую процент Принятой Стоимости Контракта, указанный в Уведомлении о принятии Конкурсного предложения за вычетом суммы на непредвиденные расходы, если таковые имеются, выраженные либо в валюте(-ах) Контракта, либо в свободно конвертируемой валюте, приемлемой для Заказчика.

² Вставьте дату – двадцать восемь дней после Намеченной даты последней поставки. Заказчик должен учесть, что в случае продления срока действия Контракта, Заказчику необходимо запросить у Гаранта продление данной гарантии. Такой запрос должен быть направлен в письменном виде до истечения срока действия данной гарантии. При подготовке данной гарантии Заказчик может рассмотреть возможность добавления в форму в конце предпоследнего параграфа следующего текста: “Гарант соглашается продлить срок данной гарантии на период, не превышающий [шесть месяцев] [один год] в ответ на письменный запрос Бенефициара о продлении, данный запрос должен быть направлен Гаранту до истечения срока данной гарантии”.



Распоряжение Президента Республики Беларусь

21 августа 2017 г.

№ 135рп

г. Минск

О реализации Соглашения о займе

В целях реализации Соглашения о займе (проект "Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь") между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития от 25 ноября 2016 года (далее – Соглашение), направленного на внедрение в республике электронного здравоохранения, современных технологий подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников, а также методик, обеспечивающих необходимое качество оказания медицинской помощи населению:

1. Предоставить средства займа Международного банка реконструкции и развития в сумме 125 млн. долларов США (далее – заем) государственному учреждению "Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения" (далее – РНПЦ МТ), являющемуся исполнительной организацией, ответственной за реализацию Соглашения.

2. Установить, что плата в республиканский бюджет за предоставление средств займа с РНПЦ МТ не взимается.

3. РНПЦ МТ средства займа направить на реализацию мероприятий компонентов 1 – 4 приложения 1 к Соглашению и распределить:

3.1. 118 995 480 долларов США (удельный вес в сумме займа – 95,2 процента) – средства, подлежащие погашению и обслуживанию за счет республиканского бюджета;

3.2. 6 004 520 долларов США (удельный вес в сумме займа – 4,8 процента) – средства, подлежащие погашению и обслуживанию за счет местных бюджетов, в том числе:

Брестской области – 966 922 доллара США (удельный вес в сумме займа – 0,77 процента);

Витебской области – 1 034 353 доллара США (удельный вес в сумме займа – 0,83 процента);

Гомельской области – 692 936 долларов США (удельный вес в сумме займа – 0,55 процента);

Гродненской области – 690 207 долларов США (удельный вес в сумме займа – 0,55 процента);

Минской области – 1 052 575 долларов США (удельный вес в сумме займа – 0,84 процента);

Могилевской области – 683 585 долларов США (удельный вес в сумме займа – 0,55 процента);

городу Минску – 883 942 доллара США (удельный вес в сумме займа – 0,71 процента).

4. Определить, что заказчиками по строительству объектов, финансируемых за счет средств займа (далее – заказчики), являются государственные организации, подчиненные Министерству здравоохранения, облисполкомам, Минскому горисполкому. Перечень таких государственных организаций и объектов утверждается Министерством здравоохранения по согласованию с облисполкомами, Минским горисполкомом.

5. Установить, что по 31 мая 2022 г. освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость обороты по реализации на территории Республики Беларусь:

5.1. генеральными подрядчиками (субподрядчиками), генеральными проектными организациями заказчиком товаров (работ, услуг) в целях реализации Соглашения.

Суммы налога на добавленную стоимость, признаваемые в соответствии с законодательством налоговыми вычетами (за исключением сумм налога на добавленную стоимость, не подлежащих вычету), предъявленные генеральным подрядчикам (субподрядчикам), генеральным проектными организациями при приобретении товаров (работ, услуг) (уплаченные генеральными подрядчиками (субподрядчиками), генеральными проектными организациями при ввозе товаров с территории государств – членов Евразийского экономического союза), использованных в целях реализации Соглашения, и приходящиеся на обороты, освобождаемые от налога на добавленную стоимость в соответствии с частью первой настоящего подпункта, подлежат вычету соответственно у генеральных подрядчиков (субподрядчиков), генеральных проектных организаций в полном объеме независимо от сумм налога на добавленную стоимость, исчисленных с оборотов по реализации товаров (работ, услуг). Суммы налога на добавленную стоимость, принимаемые к вычету в полном объеме и приходящиеся на обороты, освобождаемые от налога на добавленную стоимость в соответствии с частью первой настоящего подпункта, определяются методом раздельного учета налоговых вычетов в зависимости от направлений использования приобретенных товаров (работ, услуг).

Основанием для освобождения от налога на добавленную стоимость оборотов по реализации товаров (работ, услуг), указанных в части первой

настоящего подпункта, и осуществления налоговых вычетов в порядке, установленном в части второй настоящего подпункта, является представлением соответственно генеральными подрядчиками (субподрядчиками), генеральными проектными организациями в налоговый орган по месту постановки на учет одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по налогу на добавленную стоимость заключения Министерства здравоохранения, содержащего в отношении:

реализованных товаров (работ, услуг), указанных в части первой настоящего подпункта, – сведения о наименовании генеральных подрядчиков (субподрядчиков), генеральных проектных организаций, их учетном номере плательщика, периоде реализации товаров (работ, услуг), наименовании, количестве, стоимости товаров (работ, услуг), реквизитах первичных учетных документов, подтверждающих сумму оборотов по реализации таких товаров (работ, услуг) (наименование документа, дата его составления, номер – при его наличии), наименовании заказчика, его учетном номере плательщика, наименовании объекта. Данное заключение должно подтверждать, что реализация товаров (работ, услуг), указанных в части первой настоящего подпункта, осуществляется генеральными подрядчиками (субподрядчиками), генеральными проектными организациями в целях реализации Соглашения;

приобретенных (ввезенных) товаров (работ, услуг), указанных в части второй настоящего подпункта, – сведения о наименовании плательщика, его учетном номере, периоде приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), наименовании объекта, наименовании, количестве, стоимости этих товаров (работ, услуг) с указанием сумм налога на добавленную стоимость, реквизитах электронных счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость (номер, дата подписания генеральным подрядчиком (субподрядчиком), генеральной проектной организацией), реквизитах документов, подтверждающих приобретение (ввоз) товаров (работ, услуг), использованных в целях реализации Соглашения, их использование в целях реализации Соглашения (наименование документа, дата его составления, номер – при его наличии). Данное заключение должно подтверждать, что товары (работы, услуги), указанные в части второй настоящего подпункта, приобретены (ввезены) генеральными подрядчиками (субподрядчиками), генеральными проектными организациями и использованы в целях реализации Соглашения;

5.2. иностранными организациями, не осуществляющими деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное представительство и не состоящими в связи с этим на учете в налоговых органах Республики Беларусь, работ, услуг по договорам, заключенным с РНПЦ МТ, в целях реализации Соглашения.

Основанием для освобождения от налога на добавленную стоимость оборотов по реализации работ, услуг, указанных в части первой настоящего подпункта, является представление РНПЦ МТ в налоговый орган по месту постановки на учет одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по налогу на добавленную стоимость заключения Министерства здравоохранения:

подтверждающего, что приобретение РНПЦ МТ работ, услуг, указанных в части первой настоящего подпункта, осуществляется в целях реализации Соглашения;

содержащего сведения о наименовании иностранной организации, присвоенном ей идентификационном коде (номере) налогоплательщика, периоде реализации работ, услуг, наименовании, стоимости работ, услуг, реквизитах документов, подтверждающих приобретение и оплату работ, услуг РНПЦ МТ;

5.3. белорусскими организациями товаров (работ, услуг) по договорам, заключенным с РНПЦ МТ, в целях реализации Соглашения.

Суммы налога на добавленную стоимость, признаваемые в соответствии с законодательством налоговыми вычетами (за исключением сумм налога на добавленную стоимость, не подлежащих вычету), предъявленные белорусским организациям при приобретении товаров (работ, услуг), использованных для выполнения договоров, указанных в части первой настоящего подпункта, в целях реализации Соглашения, и приходящиеся на обороты, освобождаемые от налога на добавленную стоимость согласно части первой настоящего подпункта, подлежат вычету у белорусских организаций в пределах сумм налога на добавленную стоимость, исчисленных с оборотов по реализации товаров (работ, услуг), и определяются методом раздельного учета налоговых вычетов в зависимости от направлений использования приобретенных товаров (работ, услуг).

Основанием для освобождения от налога на добавленную стоимость оборотов по реализации товаров (работ, услуг), указанных в части первой настоящего подпункта, и осуществления налоговых вычетов в порядке, установленном в части второй настоящего подпункта, является представление белорусскими организациями в налоговый орган по месту постановки на учет одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по налогу на добавленную стоимость заключения Министерства здравоохранения, содержащего в отношении:

реализованных товаров (работ, услуг), указанных в части первой настоящего подпункта, – сведения о наименовании плательщика, его учетном номере, периоде реализации товаров (работ, услуг), их стоимости, реквизитах договоров, заключенных с РНПЦ МТ, и первичных учетных документов, подтверждающих сумму оборотов по реализации таких товаров (работ, услуг) (наименование первичного учетного документа,

дата его составления, номер – при его наличии). Данное заключение должно подтверждать, что реализация товаров (работ, услуг) осуществляется белорусскими организациями для выполнения договоров, указанных в части первой настоящего подпункта, в целях реализации Соглашения;

приобретенных товаров (работ, услуг) – сведения о наименовании плательщика, его учетном номере, периоде приобретения товаров (работ, услуг), стоимости этих товаров (работ, услуг) с указанием сумм налога на добавленную стоимость, реквизитах электронных счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость (номер, дата подписания белорусской организацией), реквизитах документов, подтверждающих приобретение товаров (работ, услуг), использованных для выполнения договоров, указанных в части первой настоящего подпункта, их использование для выполнения этих договоров (наименование документа, дата его составления, номер – при его наличии). Данное заключение должно подтверждать, что товары (работы, услуги), указанные в части второй настоящего подпункта, приобретены белорусскими организациями и использованы для выполнения договоров, указанных в части первой настоящего подпункта, в целях реализации Соглашения.

6. Освободить от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, взимаемых таможенными органами, оборудование, включая машины, механизмы, а также материалы, входящие в комплект поставки соответствующего оборудования, и комплектующие изделия (за исключением подакцизных), ввозимые за счет средств займа, предоставленного в рамках Соглашения (далее – товары).

Основанием для освобождения, установленного в части первой настоящего пункта, является представление в таможенный орган заключения Министерства здравоохранения о предназначении ввозимых товаров для исключительного использования на территории Республики Беларусь в целях реализации Соглашения, содержащего сведения о наименовании, количестве и стоимости товаров, лицах, осуществляющих их ввоз, реквизитах внешнеэкономических договоров, на основании которых осуществляется ввоз товаров.

В отношении товаров, ввезенных с применением освобождения в соответствии с частью первой настоящего пункта и использованных для реализации Соглашения, ограничения по использованию и (или) распоряжению такими товарами действуют до даты окончания реализации проекта "Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь", но не более пяти лет со дня помещения таких товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

В случае нецелевого использования товаров, ввезенных с применением освобождения в соответствии с частью первой настоящего пункта, ввозные таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость уплачиваются (взыскиваются) в соответствии с законодательством.

7. Министерству здравоохранения:

7.1. обеспечить общий надзор, контроль за своевременным выполнением мероприятий и целевым использованием средств займа в соответствии с Соглашением;

7.2. при необходимости вносить изменения в распределение средств займа на реализацию соответствующих мероприятий компонентов 1 – 4 приложения 1 к Соглашению по согласованию с Министерством финансов, облисполкомами, Минским горисполкомом;

7.3. информировать Государственный таможенный комитет о дате окончания реализации проекта "Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь".

8. Министерству финансов в 2018 – 2031 годах осуществлять погашение и обслуживание займа за счет средств республиканского бюджета не позднее 15 марта и 15 сентября ежегодно.

9. Облисполкомам, Минскому горисполкому:

9.1. обеспечить перечисление не позднее 5 марта и 5 сентября 2018 – 2031 годов ежегодно в республиканский бюджет платежей по погашению и обслуживанию займа за счет средств соответствующих местных бюджетов согласно удельному весу, определенному в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего распоряжения;

9.2. предусматривать при формировании местных бюджетов средства на погашение и обслуживание займа с учетом требований, установленных в подпункте 9.1 настоящего пункта;

9.3. обеспечить контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Соглашением, в соответствующих областях, г.Минске и целевым использованием подчиненными организациями средств займа.

10. Министерству здравоохранения, облисполкомам, Минскому горисполкому, РНПЦ МТ заключить с Министерством финансов договоры о порядке использования и погашения займа.

11. Совету Министров Республики Беларусь:

11.1. при подготовке проекта нормативного правового акта об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2017 год и формировании проектов республиканского бюджета на 2018 – 2031 финансовые годы предусматривать необходимые средства на цели, указанные в пункте 8 настоящего распоряжения;

11.2. в случае неисполнения облисполкомами, Минским горисполкомом обязательств, указанных в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего распоряжения, при подготовке проекта нормативного правового акта об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета предусматривать уменьшение размера дотаций, подлежащих передаче из республиканского бюджета в соответствующие местные бюджеты, и (или) перечисление межбюджетных трансфертов из местных бюджетов в республиканский бюджет на сумму обязательств, не исполненных в соответствующем году.

12. Персональную ответственность за использование по целевому назначению предусмотренных Соглашением средств займа возложить на Министра здравоохранения.

13. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Комитет государственного контроля.

Президент
Республики Беларусь



А.Лукашенко

09

